M2720A Avalon CTS Kablosuz Fetal Transdüser Sistemi

Uyarılar ve Yapılması Gerekenler

Baz İstasyonu Uyarıları: tek başına veya iki yanındaki lambalarla birlikte yanıp söner. lamba kapalı veya sürekli açık.

ayarlandıysa, sesli uyarı duyduğunuzu gösterir. Susturmak için C tuşuna basın.

Transdüser Uyarıları: sorunun kaynağını belirten sembolle birlikte yanıp söner.

Bu uyarıyı alırsanız...		**...Şunları yapın...**
...Baz istasyonunda...	**...Trandüserde…**	
		Pili şarj etmek için transdüseri baz istasyonuna takın veya şarj edilmiş bir transdüserle değiştirin. 30 dakika şarj ettikten sonra sorun hala devam ediyorsa, transdüser pilini değiştirin. (Bkz. *Servis Kılavuzu*.)
		Transdüserin aktif ve kapsama alanı içinde olup olmadığını kontrol edin. Anten bağlantısını kontrol edin.
		C tuşuna iki saniye boyunca basarak bloke yuvayı açın.
Örnek yatak etiketi		Bu yuvada zaten **aktif** bir transdüser var (bu örnekte yatak etiketi 38 gösteriliyor). *Ya* yuvayı kullanabilmek için önce bunu takın; *Ya da* transdüser yatak etiketi gösteriyorsa (bu örnekte 16) baz istasyonuna geri götürün.
Örnek yatak etiketi	Örnek yatak etiketi	
		Desteği arayın (transdüser kaydolamıyor).
		Aktif EKG transdüserse, kablosunu takın. Transdüseri noktayla belirtilen yuvaya yerleştirin (transdüser yanlış yuvada).
Baz istasyonu ve transdüser Hata Mesajları (E0 – E9): *Bkz. Kullanım Talimatları*		

© 1995-2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm Hakları Saklıdır.
Almanya'da basılmıştır, 03/2006
Parça No. M2720-9046B
4512 610 15031

Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
Hewlett-Packard-Str.2
71034 Boeblingen, Almanya

PHILIPS

M2720A Avalon CTS Kablosuz Fetal Transdüser Sistemi
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu

1 110 - 240 V AC



2 Gücü açın

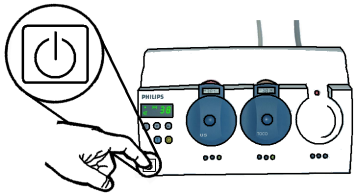

3

TELE

Fetal monitörde “TELE” sinyalinin yanıp yanmadığını kontrol edin. Yanıyorsa, Avalon CTS ile sorunsuz bağlantı var demektir

4 “Hazır” lambasının yanmasını bekleyin



5 Transdüseri çıkarın



“Hazır” lambası söner: “RF Bağlantısı” lambası yanar



6 Transdüseri uygulayın (US için jel kullanın)

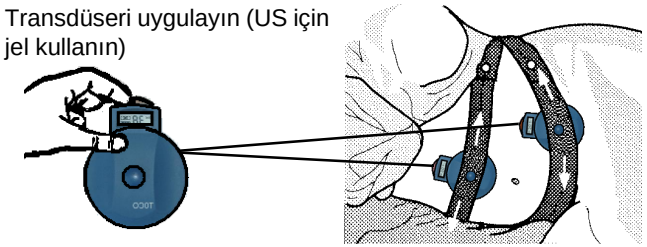

Sonra iyi sinyal aldığınız bir konumda tutun:

Avalon monitörlerde

50 Serisi monitörlerde

US izlemeden DEKG izlemeye geçme	
1	US transdüseri yuvaya takın.
2	Bu yuvanın lambası yeşil yandığında, EKG transdüseri çıkarın.
3	DEKG adaptör kablosu ve fetal baş elektrodunu EKG transdüsere takın.
4	DEKG izlemesine başlayın.

DEKG izlemeden US izlemeye geçme	
1	DEKG adaptör kablosu ve fetal baş elektrodunu EKG transdüserden çıkarın.
2	EKG transdüseri yuvaya takın.
3	Bu yuvanın lambası yeşil yandığında, US transdüseri çıkarın.
4	Ultrason izlemesine başlayın.

Avalon CTS’yi kullanmadan önce tüm kablolu fetal transdüserleri monitörden çıkarın.

Aynı baz istasyonuna FHR gönderen iki aktif transdüser varsa **E9** hata mesajı verilir. Düzeltmek için yuvaya bir transdüser takın.

Kullandıktan sonra transdüserleri temizleyin. Sonra da uygun baz istasyonu yuvasına takın.